

Inhalt

Allgemeine Informationen und Sicherheitshinweise	5
Garantieinformation.....	5
Technische Unterstützung	5
Vermerk der Urheberrechte	5
Druckversion	5
Im Handbuch verwendete Sicherheitssymbole	6
Sicherheitsanweisungen für alle DEWETRON Systeme	7
Umweltschutz	8
Grundsystem	9
DEWE-510 Akkubetriebenes Messsystem	9
Spezifikationen.....	9
Anschlüsse	10
A/D & D/A Wandler	A1
Interne Verdrahtung	B1
CE Konformitätserklärung	C1

Technische Referenz

Technische Änderung, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

DEWETRON elektronische Messgeraete Ges.m.b.H. (DEWETRON) erhebt keinen Anspruch auf die Wirksamkeit oder die Genauigkeit der Informationen, die hierin enthalten sind. Die Verwendung dieses Handbuchs erfolgt ausschließlich auf Risiko des Benutzers. Unter keinen Umständen übernimmt DEWETRON eine Verantwortung für Probleme, die durch korrekte oder inkorrekte Verwendung dieses Manuals oder dessen graphischen oder Textinhalt entstanden sind.

Garantieinformation

Eine Kopie der Gewährleistungsbestimmungen für Ihr DEWETRON Produkt, sowie Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrer DEWETRON Vertretung bzw. im DEWETRON Servicebüro.

Technische Unterstützung

Für technische Unterstützung kontaktieren Sie bitte zuerst Ihre nächste DEWETRON Verkaufsstelle oder wenden sich direkt an DEWETRON.

Für Asien und Europa kontaktieren Sie bitte:

DEWETRON Ges.m.b.H.
Parkring 4
A-8074 Graz-Grambach
AUSTRIA
Tel.: +43 316 3070
Fax: +43 316 307090
Email: support@dewetron.com
Web: <http://www.dewetron.com>

Die Telefonhotline ist Montags bis Freitags zwischen 08:00 und 17:00 Uhr erreichbar

For the Americas, please contact:

DEWETRON, Inc.
10 High Street, Suite K
Wakefield, RI 02879
U.S.A.
Tel.: +1 401 284 3750
Toll-free: +1 877 431 5166
Fax: +1 401 284 3755
Email: support@dewamerica.com
Web: <http://www.dewamerica.com>

The telephone hotline is available Monday to Friday between 08:00 and 17:00 GST (GMT -5:00)

Vermerk der Urheberrechte

Veröffentlichung und Vervielfältigung nach österreichischem Recht.

DEWETRON GesmbH
Parkring 4
A-8074 Graz-Grambach
Austria

Druckversion

Die Druckversion dieses Dokuments ersehen Sie in der Fußzeile.

Copyright © DEWETRON elektronische Messgeraete Ges.m.b.H.

In dieser technischen Referenz sind Copyright-geschützte Informationen enthalten. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Änderung oder Übersetzung ohne schriftliche Genehmigung wird untersagt, ausgenommen es wird in den Copyrightbestimmungen erlaubt.

Alle eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Es sind keine Verletzungen der jeweiligen Rechte beabsichtigt.

Sicherheitsanweisungen

Im Handbuch verwendete Sicherheitssymbole



Symbolisiert gefährliche Spannungen.

WARNUNG *Warnt vor Fehlbedienungen und Betriebsumgebungen die eine Verletzungsgefahr darstellen.*

Vorsicht *Warnt vor Fehlbedienungen und Betriebsumgebungen die eine Beschädigung des Gerätes oder einen Datenverlust nach sich ziehen.*

WARNUNGEN

Die folgenden Sicherheitsinstruktionen müssen während dem Betrieb und bei Servicearbeiten bzw. Reparaturen unbedingt eingehalten werden. Eine Mißachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen in diesem Manual oder am Gerät verletzt die Sicherheitsstandards des Geräteaufbaus und die vorgesehene Nutzung des Gerätes. DEWETRON Elektronische Messgeraete Ges.m.b.H. haftet nicht für Schäden die durch Mißachtung der Sicherheitsinstruktionen entstanden sind.

Das in diesem Handbuch abgebildete Zubehör ist optionell erhältlich und wird nicht standardmäßig mitgeliefert.



Aus Sicherheitsgründen dürfen maximal 50 V an den BNC Eingängen angelegt werden. Halten Sie die Bestimmungen für die zulässige Berührungsspannung ein!

Sicherheitsanweisungen für alle DEWETRON Systeme

- DEWETRON Messgeräte dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal installiert werden.
- Lesen Sie das Handbuch vor Inbetriebnahme des Gerätes.
- Beim Betrieb des Gerätes sind die lokalen Gesetze zu beachten.
- Erdung der Anlagenteile: Geräte der Schutzklasse 1 (Geräte mit Schutzleiteranschluss) müssen über eine nicht lösbare Verbindung mit der Spannungsversorgung geerdet werden. Dies kann entweder über die Anschlussklemmen am Gerät oder das mitgelieferte Versorgungskabel erfolgen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT in explosionsgefährdeter Umgebung oder in der Nähe von leicht entzündlichen Stoffen oder Gasen und schützen Sie das Gerät vor der Berührung mit Wasser.
- Verwenden Sie KEIN beschädigtes Gerät: Wenn Verdacht auf eine Beschädigung durch zu starke mechanische Beanspruchung, feuchte Umgebung oder ähnliche Einflüsse gegeben ist, TRENNEN Sie das Gerät VOM NETZ und verwenden es erst nachdem es in einer autorisierten Servicestelle überprüft worden ist. Wenn nötig retournieren Sie das Gerät an eine DEWETRON Vertriebs- und Service Niederlassung wo es repariert wird, damit die Betriebssicherheit wieder hergestellt ist.
- Arbeiten Sie nicht unter Spannung: Die Schutzabdeckungen dürfen vom Bediener nicht abgenommen werden. Die Anleitungen zur Demontage der Schutzabdeckungen sind ausschließlich für autorisiertes Fachpersonal bestimmt. Unter Umständen können am Gerät auch im ausgeschalteten Zustand gefährliche Spannungen anliegen. Beim öffnen des Gerätes oder entfernen von Schutzabdeckungen durch Laien besteht die GEFAHR von lebensgefährlichen Stromschlägen.
- Umbauten am Messinstrument sind nicht erlaubt. Die Netzteilsicherung darf nur durch eine Sicherung des gleichen Typs ersetzt werden. Um den Brandschutz aufrecht zu erhalten darf die Netzsicherung nur durch Sicherungen des gleichen Typs (Spannung, Strom, Auslöseverhalten) ersetzt werden. Verwenden Sie KEINE geflickten Sicherungen und ändern Sie nicht den Aufbau der Sicherungshalterung (Kurzschluss oder Entfernung).
- Führen Sie Service und Einstellarbeiten NICHT ALLEIN durch. Sorgen Sie bei Servicearbeiten für die Anwesenheit einer Person mit Erste Hilfe bzw. Wiederbelebungsausbildung.
- Unterlassen Sie das Ersetzen und Ändern der Originalteile: Durch den Einbau von Ersatzteilen und unzulässige Modifikationen am Gerät entstehen zusätzliche Gefahren. Wenn nötig retournieren Sie das Gerät an eine DEWETRON Vertriebs- und Service Niederlassung wo es repariert wird, damit die Betriebssicherheit wieder hergestellt ist.
- Vor dem Öffnen des Gerätes (nur autorisiertes Fachpersonal) oder wechseln der Sicherung trennen Sie das Gerät unbedingt von der Spannungsversorgung.
- Die interne Verdrahtung darf nicht berührt werden!
- Überschreiten Sie die angegebene Versorgungsspannung keinesfalls und achten Sie auf die richtige Polarität, andernfalls wird das Gerät zerstört!
- Verwenden Sie für die Verkabelung nur Originalstecker und Kabel.
- Montieren Sie Blindabdeckungen an den unbenützten Steckplätzen.
- Das Spannungsversorgungskabel und der Versorgungsstecker dienen zur Trennung von der Versorgungsspannung. Darum darf das Kabel eine Länge von 3 m nicht überschreiten und muß ohne Werkzeug aussteckbar sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze frei sind und überprüfen Sie diese regelmäßig um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden. Der Zeitintervall für die Reinigung der Filtermatten hängt von den Umgebungsbedingungen ab.
- Die Sicherheit von Anwender und Gerät hängt von der Einhaltung dieser Bestimmungen ab
- DEWETRON übernimmt keine Haftung für Schäden die durch fehlerhafte Beschaltung bzw. Missachtung der angeführten Instruktionen entstehen!

Allgemeine Informationen

Vorsicht

- Das System BIOS ist Passwortgeschützt. Jegliche Änderungen im BIOS können einen Systemabsturz verursachen. Drücken Sie während dem Hochstarten keinesfalls die ESC-Taste auf Ihrer Tastatur. Sie würden die BIOS Einstellungen löschen und Systemstörungen verursachen.
- Änderungen der Datenstruktur wie z.B. Löschen und Hinzufügen von Dateien oder Ordnern können Systemabstürze verursachen.
- Vor der Installation von Softwareaktualisierungen kontaktieren Sie DEWETRON oder Ihre nächste DEWETRON Verkaufsstelle. Verwenden Sie nur von DEWETRON erstellte Softwarepakete. Weitere Informationen finden Sie im Internet (<http://www.dewetron.com>).
- Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden bevor Sie das Gerät wieder einschalten. Das Gerät kann sonst nicht korrekt hochstarten. Sie verlängern damit auch die Lebenszeit aller anderen Komponenten.

Umweltschutz

Hier finden Sie Informationen über die Umweltbelastung des Systems.

Entsorgungsrichtlinien

Befolgen Sie die Wiederverwertungshinweise wenn Sie das Gerät entsorgen:

Recycling des Messsystems und der zugehörigen Komponenten

Um das System herzustellen wurden verschiedenste Materialien verwendet. Wenn es nicht fachgerecht entsorgt wird besteht die Gefahr von Umweltschäden bzw. kann dies zu gesundheitlichen Schäden führen. Führen Sie das Gerät einer entsprechenden Wiederverwertung zu um in weiterer Folge Rohstoffe zu sparen und die Umwelt zu schützen.



Dieses Symbol bedeutet, dass das System den Anforderungen der Europäischen Union gemäß der Richtlinie 2002/96/EC betreffend Elektro- und Elektronikschrott (WEEE) entspricht. Weitere Informationen zum Thema Recycling finden Sie auf unserer Internetseite: www.dewetron.com

Verwendung gefährlicher bzw. umweltschädlicher Stoffe

Dieses Gerät gehört zur Klasse der Überwachungs- und Steuergeräte und fällt somit nicht in die 2002/95/EC RoHS Bestimmungen. Die Elektronik im Gerät kann Spuren von Blei enthalten!

DEWE-510 Akkubetriebenes Messsystem

- Portables batteriebetriebenes Mehrkanal - Messsystem
- Bis zu 2 DEWE-ORION-3216 A/D Karten mit 64 A/D Wandlern
- 16 interne Steckplätze für DEWE-DAQ/PAD Module
- Bis zu 10 Zähler- / Impulsgeber Eingänge
- A/D Wandlerspezifikationen finden Sie im Anhang A




Spezifikationen


	DEWE-510 DC	
Netzteil	18 bis 24 V _{DC}	
Akkumanagement	<input type="checkbox"/> BBDC-02 (120 W) <input type="checkbox"/> BB-04 (150 W) <input type="checkbox"/> MP-04 (192 W) <input type="checkbox"/> XP-04 (320 W)	
DC-DC Konverter	<input type="checkbox"/> Zwei DC-DC Konverter Module <input type="checkbox"/> DC-023 <input type="checkbox"/> DC-023-12V <input type="checkbox"/> DC-123 Details finden Sie auf den nächsten Seiten	
Betriebstemperatur	-10 °C to +50 °C	
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C	
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % bis 80 %, nicht kondensierend 5 % bis 95 %, rel. Luftfeuchtigkeit	
Vibrationstest nach EN 60068-2-6	Schwingungsform	Sinus
	Frequenzbereich	10 - 150 Hz
	Beschleunigungsamplitude	2 g
	Frequenzänderungsgeschwindigkeit	1 Okt./min.
	Dauer	20 Zyklen
	Prüfung in 3 Hauptachsrichtungen	
Vibrationstest nach EN 60721-3-2 Klasse 2M2	Schwingungsform	Rauschförmig
	Frequenzbereich	10 - 200 Hz
	Beschleunigungsdichte	1 m/s ² / Hz von 10 – 200 Hz
	Dauer	30 Minuten pro Achsrichtung
Shocktests EN 60068-2-27	Impulsform	Halbsinus
	Beschleunigung	15 g
	Impulsdauer	11 ms
	Prüfung in 3 Hauptachsrichtungen, 3 Schocks je Richtung und Achse	
Abmessungen (B x T x H)	DEWE-510: 438 x 308 x 180.5 mm (17.3 x 12.1 x 7.1 in.)	
Gewicht	typ. 6 bis 10 kg (13.2 bis 22 lbs), Abhängig von der Konfiguration	

Grundsystem

Anschlüsse

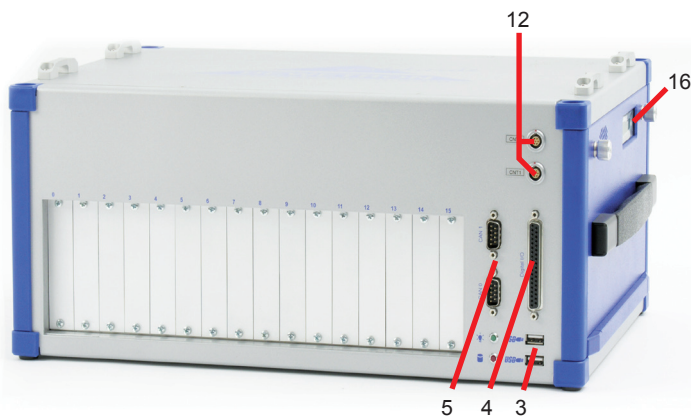

Typische DEWE-510 Vorderseite

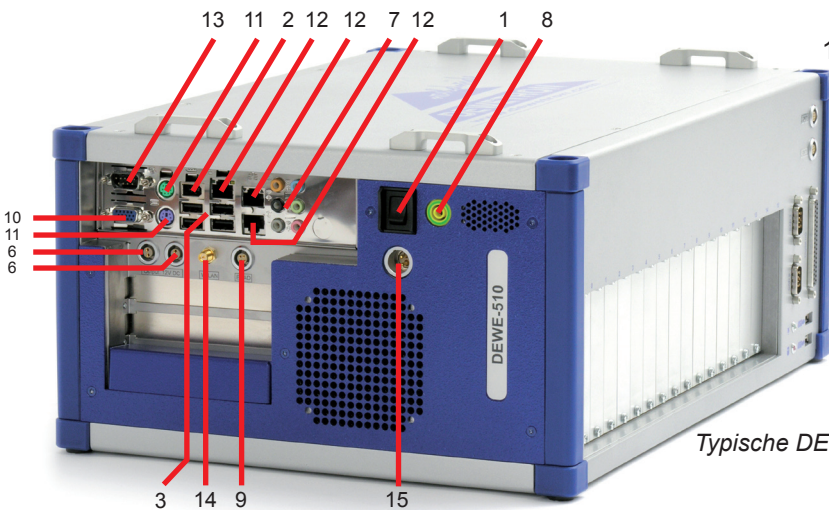



Typische DEWE-510 Seitenansicht

Anschlussübersicht:

- 1 Ein / Aus Taster
- 2 Akkus
- 3 USB Anschluss
- 4 Digital I/O
- 5 CAN Schnittstelle
- 6 Spannungsvers. für Zubehör (12 V_{DC} / 1.8 A) Lemo FGG1B-302
- 7 Soundausgabe
- 8 Erdungsanschluss
- 9 EPAD Anschluss
- 10 VGA Anschluss
- 11 PS/2 Anschluss
- 12 Netzwerkanschluss
- 13 RS-232 Anschluss
- 14 VGPS Anschluss
- 15 Spannungsversorgungsstecker (Lemo FGJ3B-30)
- 16 Batteriestatus Display

Achtung: Die Position der Anschlüsse hängt von der Systemkonfiguration ab und kann variieren

Abmessungen*

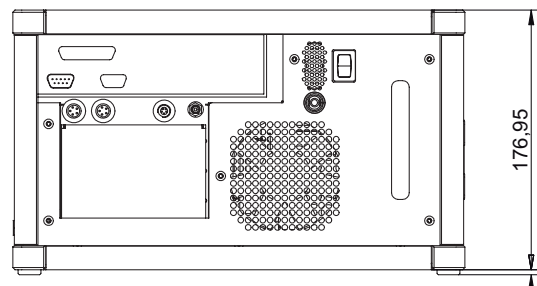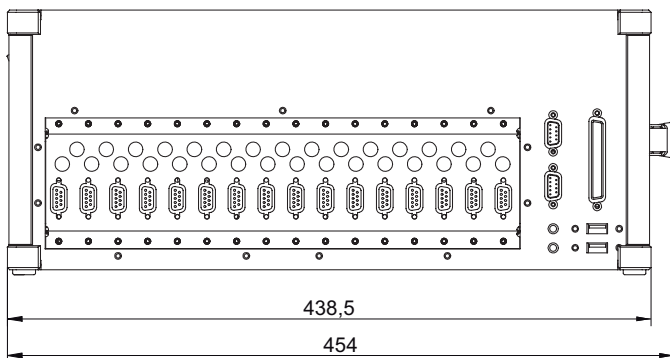

* Angaben in mm
(1 inch = 25.4 mm)

Spannungsversorgung

Internes DC Netzteil

DC Netzteil			
Eingang:			
Eingangsspannung:	18 bis 24 V _{DC} (standard 18 V _{DC})		
Eingangsfrequenz:	DC		
Max. Eingangsstrom:	12 A		
Ausgang:			
Ausgangsleistung:	120 W mit BBDC-02 (DC-DC und Akku-Platine kombiniert)		
	150 W mit BB-04 Print		
	192 W mit MP-04 Print		
	320 W mit XP-04 Print (nur ein DC-DC Konverter Modul)		
Ausgangsspannungen:	Ein DC-DC Konverter-Modul	Zwei DC-DC Konverter-Module	BBDC-02
	+3.3 V (max. 10 A)	+3.3 V (max. 19 A)	+3.3 V (max. 10 A)
	+5 V (max. 10 A)	+5 V (max. 19 A)	+5 V (max. 10 A)
	+12 V (max. 7 A / 12 A*)	+12 V (max. 13 A)	+12 V (max. 7 A)
DC-023-12V Option:	-12 V (max. 0.25 A)	-12 V (max. 0.45 A)	-12 V (max. 0.3 A)

^{*)} max. Ausgangsstrom mit XP-04 Print.

Externes DC Netzteil (optional)

DC/DC Netzteil	DEWE-DCDC-24-300-ISO
Eingang:	
Eingangsspannung:	10 bis 36 V _{DC} (der Eingang ist gegen Verpolung geschützt)
Max. Eingangsstrom:	36 A @ 10 V _{DC} Eingangsspannung (15 A @ 24V _{DC})
Eingangsstecker:	2-pin LEMO Anschluss (Stift), Typ: EGJ.3B.302.CLA
Ausgang:	
Ausgangsspannung:	24 V
Ausgangsleistung:	300 W
Ausgangsstrom:	12.5 A
Ausgangsstecker:	2-pin LEMO Anschluss (Buchse), Typ: EGG.3B.302.CLL
Betriebstemperatur:	-20 °C bis 60 °C
Leistungsmind. ab 45 °C:	8 Watt/°C
Isolationsspannung:	500 V _{DC}
Status LED:	Eine grüne LED signalisiert dass die Ausgangsspannung über 21 V _{DC} liegt
Abmessungen (B x T x H):	ca. 219 x 122 x 50 mm (8.6 x 4.8 x 2 in.)
Gewicht:	1.3 kg (2.9 lbs)
Einschaltreihenfolge:	
Zuerst das zu versorgende System und das Netzteil verbinden. Danach die Versorgung für das Netzteil anschließen.	


Das externe DCDC-24-300-ISO Netzteil ist optionell erhältlich und nicht im Standardlieferumfang enthalten. Der isolierte Eingangsspannungsbereich reicht von 10 bis 36 V_{DC}. Am Ausgang liegen 24 V_{DC} mit einer Leistung von 300 Watt an.

Je nach Konfiguration sollte die Leistungsaufnahme des DEWE-501 unter 150 Watt liegen. Der typische Leistungsbedarf liegt etwa bei 70 Watt. Wenn die Spannung der Akkus sinkt und diese mitgeladen werden müssen kann der Stromverbrauch jedoch auf 12 Ampere ansteigen, was einer Leistungsaufnahme von 280 Watt entspricht! Wird das System an einem typischen Bordnetz von 12 V betrieben bedeutet das eine Stromaufnahme von 28 Ampere!

Grundsystem

Wenn diese hohe Leistung nicht zur Verfügung steht sollte der DEWE-501 mit vollen Akkus oder ohne Akkus am Bordnetz betrieben werden!


Abmessungen*

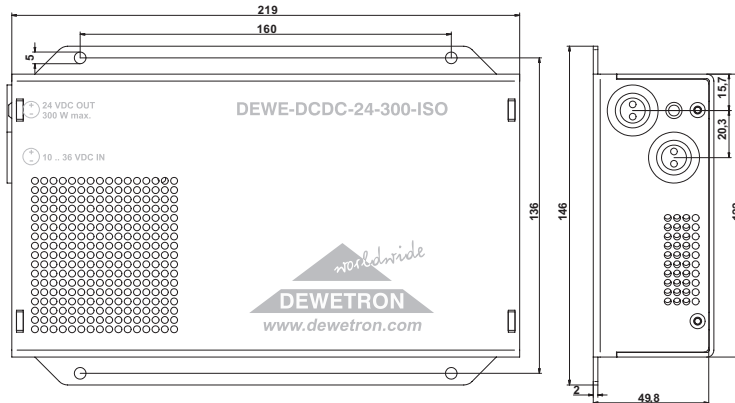

* Angaben in mm
(1 inch = 25.4 mm)

Akkus wechseln


Der DEWE-510 DC unterstützt bis zu 3 Slots für Batterien. Um die Akkus zu tauschen öffnen Sie die beiden Schrauben auf der rechten Seite ihres Systems und klappen anschließend die Verkleidung nach unten.

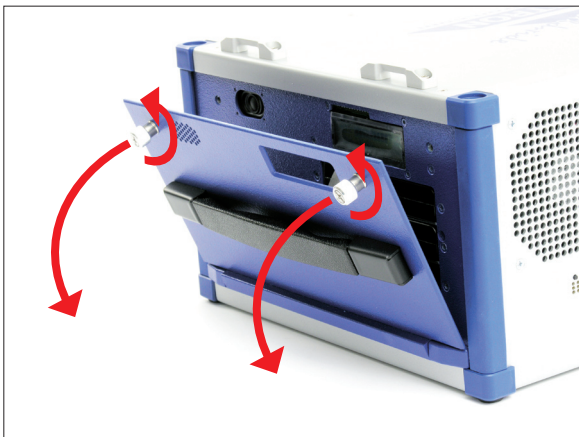

Achtung: Sollten Sie ihr DEWE-510 System für eine längere Zeit nicht benutzen, so entfernen Sie bitte die Akkus und bewahren sie getrennt auf, um eventuelle Beschädigungen am System zu verhindern.

LCD Display für die Akkuanzeige

Das LCD Display beinhaltet 2 Zeilen an Informationen. In der ersten Zeile befindet sich ein Ladebalken, welcher die restliche Kapazität des Akkus veranschaulicht. Die erste Zeile des Displays zeigt auch, ob der Akku geladen bzw. entladen wird.

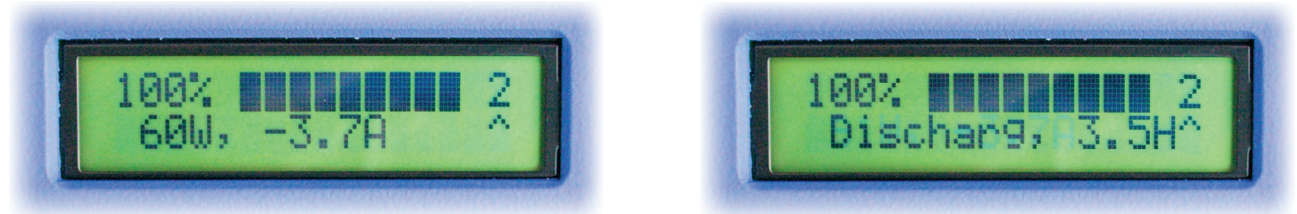

Die zweite Zeile gibt Aufschluss über den Energieverbrauch und zeigt entweder den Ladestrom oder Laststrom an. Ausserdem ist es möglich die verbleibende Zeit bis der Akku geladen ist, oder aber die Zeit bis zur totalen Entladung darzustellen.

PS/2 Maus- / Tastaturanschluss

Der Maus- / Tastaturanschluss kann zum Anschluss PS/2 kompatibler Geräte verwendet werden.

USB Schnittstelle (Universeller Serieller Bus)


Standard Steckerbelegung zum Anschluss von USB Geräten.

RS-232 Schnittstelle (COM1)

Die RS-232 Schnittstelle (Stift) befindet sich an der Rückseite des Systems und ist als Standard RS-232 Schnittstelle konfiguriert.



9 pol. SUB-D Stecker (Stift)



Schaltbild


Steckerbelegung

- 1: DCD (Data Carrier Detector)
- 2: RD (Received Data)
- 3: TD (Transmitted Data)
- 4: DTR (Data Terminal Ready)
- 5: GND (Ground)
- 6: DSR (Data Set Ready)
- 7: RTS (Request To Send)
- 8: CTS (Clear To Send)
- 9: RI (Ring Indicator)


Grundsystem

VGA Monitorstecker

Zum Anschluss eines Monitors.



15 pol Mini-SUB-D Stecker (Stift)



Schaltbild


Steckerbelegung

- 1: Red video
- 2: Green video / Sync on green
- 3: Blue video
- 4: -
- 5: -
- 6: Red video ground
- 7: Green video ground
- 8: Blue video ground
- 9: -
- 10: Ground
- 11: Ground
- 12: Data line
- 13: H-Sync / HV-Sync
- 14: V-Sync
- 15: Clock line

Zusätzlich bzw. anstelle des VGA Monitorsteckers bieten einige Systeme einen DVI Stecker zum Anschluss eines externen Monitors.



15 pol. Mini-SUB-D Stecker (Stift)



Schaltbild

Steckerbelegung

- | | | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1: TDMS-data 2- | 9: TDMS-data 1- | 17: TDMS-data 0- | C1: Analog: red |
| 2: TDMS-data 2+ | 10: TDMS-data 1+ | 18: TDMS-data 0+ | C2: Analog: green |
| 3: Shield TDMS-data 2,4 | 11: Shield TDMS-Daten 1,3 | 19: Shield TDMS-data 0,5 | C3: Analog: blue |
| 4: TDMS-data 4- | 12: TDMS-data 3- | 20: TDMS-data 5- | C4: Analog: H-Sync |
| 5: TDMS-data 4+ | 13: TDMS-data 3+ | 21: TDMS-data 5+ | C5: Analog: ground |
| 6: DDC clock | 14: +5 volt | 22: Shield TDMS-Takt | |
| 7: DDC data | 15: Ground for +5 volt | 23: TDMS-clock+ | |
| 8: Analog: V-Sync | 16: Hotplug-Detect | 24: TDMS-clock - | |

Netzwerkanschluss

Anschluss an ein 10/100 BaseT Netzwerk mit Standard RJ45 Stecker.

Ein / Aus Taster

Zum Ein- bzw. Ausschalten des Systems. Zum Ausschalten des Systems beenden Sie Windows und halten sie den Ein / Aus Taster für mehr als drei Sekunden lang gedrückt.

Digital I/O Stecker

Am Digital I/O Stecker sind die Digital Ein- und Ausgänge des eingebauten A/D Wandlers ausgeführt. Sollten am A/D Wandler keine Ein- und Ausgänge vorhanden sein, wird der Stecker nicht verkabelt. Die Steckerbelegung hängt vom A/D Wandler ab und ist im Anhang B ersichtlich.

Erdungsanschluss

Für einige Messungen wird zur Vermeidung von Potentialdifferenzen der zusätzliche Erdungsanschluss benötigt.


Spannungsversorgung für Zubehör

Versorgt diverses Zubehör mit 12 V_{DC}. Intern gesichert mit einer selbstheilenden 1.8 A Sicherung.



EPAD Anschluss

Zum Anschluss von DEWETRON EPAD-Modulen.



4 pol. LEMO
Stecker (Buchsen)

Steckerbelegung

- 1: RS-485 A
- 2: RS-485 B
- 3: +12 V
- 4: GND

Abschirmung ist auf das Gehäuse verlötet.



*Aus Sicherheitsgründen dürfen maximal 50 V an den BNC Eingängen angelegt werden.
Halten Sie die Bestimmungen für die zulässige Berührungsspannung ein!*

Grundsystem

Notizen

A/D Wandler

Diese Betriebsanleitung beinhaltet keine Details über den A/D Wandler.

Nähere Informationen zum A/D Wandler finden Sie in der betreffenden Betriebsanleitung.

D/A Wandler

Diese Betriebsanleitung beinhaltet keine Details über den D/A Wandler.

Nähere Informationen zum D/A Wandler finden Sie in der betreffenden Betriebsanleitung.

A/D & D/A Wandler

Notizen

Interne Verdrahtung

DEWE-MOTHERBOARD mit 16 Steckplätzen DAQ-MOTH-16-DE-5

Rückseite

330 kHz Filteroption

GND
+15 V ORION
-15 V ORION

16 Kanäle Single Ended Analog Ausgang (Ausgangswiderstand 15 Ohm). Die Belegung finden Sie auf der nächsten Seite.

5 V ORION
Ext. CLK
Ext. TRIG
DGND ORION
Ext. CLK 2 OUT
Ext. CLK 1 OUT (KAMERA TRIGGER)
DGND ORION
GND

16 x Analog OUT (Ausg.wid. 50 Ohm)
16 x GND

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11

RES RS-232 RS-485 POWER

DM DP TX RX
GND_C GND_C
GND_C TX RX
GND_C A B
A (RS-485) GND_C B (RS-485)
GND_P +V +12 V -12 V -V

Vorderseite

CH 0
CH 1
CH 2
CH 3
CH 4
CH 5
CH 6
CH 7
CH 8
CH 9
CH 10
CH 11
CH 12
CH 13
CH 14
CH 15

Indicator
+9 V
-9 V

1 2 3 4 5
6 7 8 9

W1 Terminierung RS-485
W2 Verbindung GND auf GND_P
W3 Verbindung +12 V auf +V (pin 6)
W4 Terminierung RS-485
W5 Verbindung Gehäuse auf GND
W6 Verbindung Gehäuse auf GND
W7 Verbindung Gehäuse auf GND
W8 Aktivierung ORION RS-485 (A)
W9 Aktivierung ORION RS-485 (B)

W10 Aktivierung Analogausgang 0 on CH 14
W11 Aktivierung Analogausgang 1 on CH 15

Achtung: Wenn Sie Signale an diese Kontakte anlegen müssen Sie vorher die Brücken W10 und W11 öffnen!


Verbindung zu CH14 (Pin 7)
Verbindung zu CH15 (Pin 7)

Das DEWE-MOTHERBOARD wird über einen DC/DC Wandler vom eingebauten Netzteil mit $\pm 12 V_{DC}$ versorgt.

Interne Verdrahtung


Anschlussbelegung Analogausgang

Stecker für DEWE-ORION-1616 A/D Karten

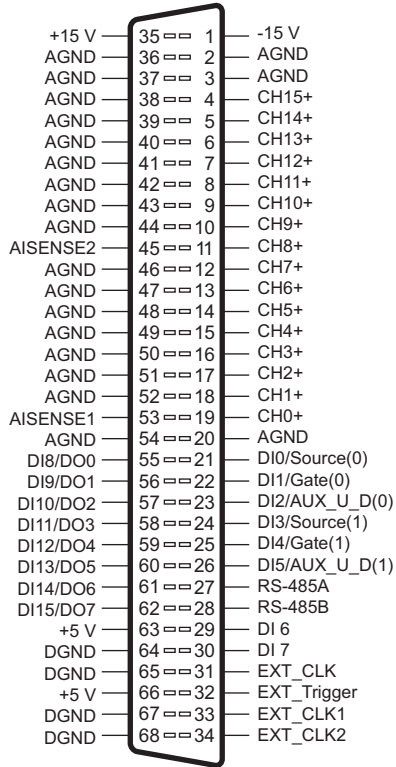

68 pol. Stecker

Stecker für DEWE-ORION-1624 A/D Karten

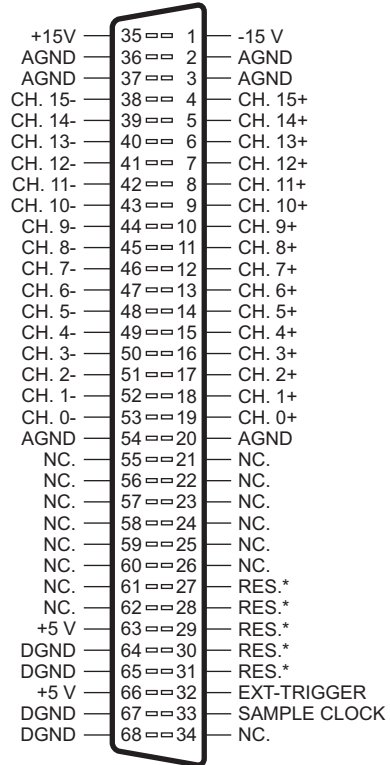

* DONT CONNECT

68 pol. Stecker

CE Konformitätserklärung

Folgende Geräte entsprechen den Normen EN50081 (Fachgrundnormen für Störaussendungen im Gewerbe- und Industriebereich) und EN50082 (Fachgrundnormen für Störfestigkeit im Gewerbe- und Industriebereich):

DEWE-2000 / DEWE-2010 / DEWE-2500 Serie

DEWE-3000 / DEWE-3010 / DEWE-3020 Serie

DEWE-4000 / DEWE-4010 Serie

DEWE-30 Serie

DEWE-50 Serie

DEWE-200 Serie

DEWE-500 Serie

DEWE-5000 Serie

DEWE-600 Serie

DEWE-800 Serie

DEWE-900 Serie


DAQ / MDAQ Modulserie

PAD / EPAD Modulserie

Hinweis: Bei Betrieb mit DC Versorgung werden verbesserte EMV Spezifikationen erreicht.

Hersteller: DEWETRON Elektronische Messgeräte Ges.m.b.H.
Parking 4
A-8074 Graz-Grambach
Austria
Tel.: +43 316 3070 0
Fax: +43 316 3070 90
e-mail: sales@dewetron.com
<http://www.dewetron.com>

Graz, 15. Nov. 2004



Ing. Herbert Wennigg
Geschäftsführer

Notizen
